


# 治療用装具の写真について

## (1) 撮影方法について

▶ 切り取り線以下の「装具作製確認書 別添 作製した装具の写真」とともに、下記の方向 及び 箇所について撮影して下さい。


- ① 正面
- ② 裏側（正面の反対側）
- ③ 右側
- ④ 左側
- ⑤ 全体図
- ⑥ 下・底
- ⑦ サイズ表記（ある場合）
- ⑧ ロゴ・商標等（ある場合）
- ⑨ 取り扱い説明書・製品箱（ある場合）

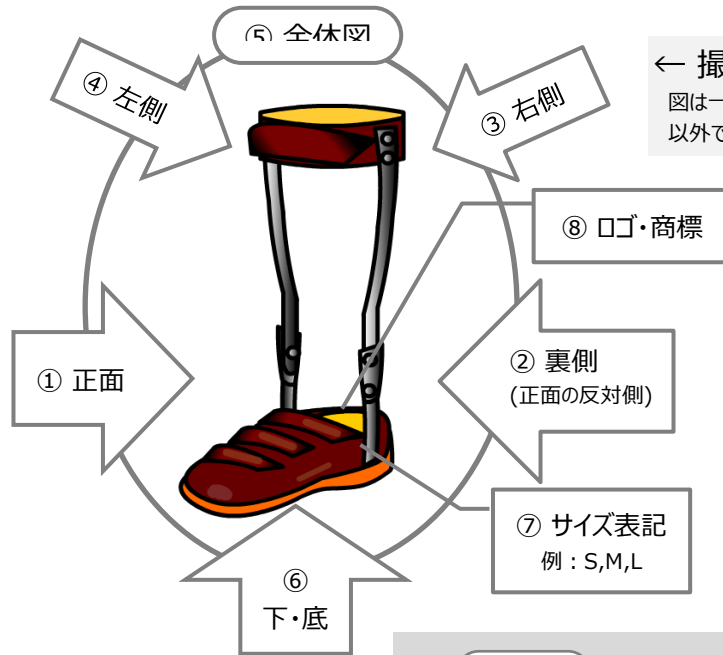

← 撮影方法の例  
図は一例です。足の装具や靴型装具以外でも同様に撮影して下さい。

### 【ご注意】

- ☆ 「装具作製確認書 別添 作製した装具の写真」が治療用装具を隠すことがないように撮影して下さい。
- ☆ 出来る限り解りやすいように撮影をお願いします。

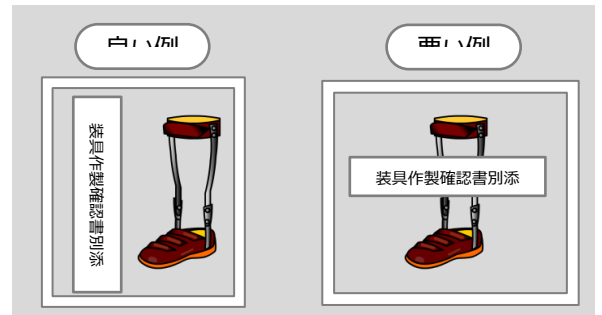

☆ デジタル画像の場合は、A4用紙に4枚程度の表示にて作成願います。  
印刷はカラーコピーも可とします。

----- ✂ ----- キリトリ ----- ✂ -----

**装具作製確認書 別添 作製した装具の写真**      **撮影者氏名**      ● ● ● ●

(1) 記号-番号		(2) 受診者名 (かな)	
XXXX-XXXXXXXXXX		受診者漢字 氏名	
(3) 療養費支給申請書に添付の「意見書 及び 装具装着証明書」に記載の事項			
① 作製した治療用装具名  <b>右短下肢装具</b>	② 装具を作製することが決まった日	28	年 8 月 1 日
	③ 装具を装着した日 (納品日)	28	年 8 月 8 日